


von
Drehmomentsensoren



und
Drehmomentmessketten



für
Rechtsdrehmoment
Linksdrehmoment
Wechseldrehmoment

nach den
Kalibriernormen

DIN 51309
EURAMET cg-14
DKD-R 10-5

- ▶ Drehmomentsensoren
- ▶ Kraftsensoren / Wägesensoren
- ▶ Messdatenauswertung
- ▶ kundenspezifische Systemlösungen
- ▶ Prüfstände, Sondersensoren
- ▶ DMS-Applizierung
- ▶ Werkskalibrierung



Das Drehmomentnormal unseres akkreditierten Kalibrierlabors dient als Referenznormal für unsere Produktion und für Werkskalibrierungen.

Lorenz Messtechnik GmbH
Oberer Schloßstraße 127/129/131
D-73553 Alfdorf
Tel. +49 7172 93730-0
Fax +49 7172 93730-22
www.lorenz-messtechnik.de
info@lorenz-messtechnik.de

D-K-17603-01-00

Drehmomentmessbereich 0,2 N·m - 200 N·m
Kleinste angebbare Messunsicherheit $\geq 1 \cdot 10^{-4}$




Drehmoment-
Bezugsnormal-
Messeinrichtung

Akkreditierung




Die Akkreditierung unseres Kalibrierlabors erfolgt durch die DAkKS (Deutsche Akkreditierungsstelle).

DAkKS-Kalibrierschein

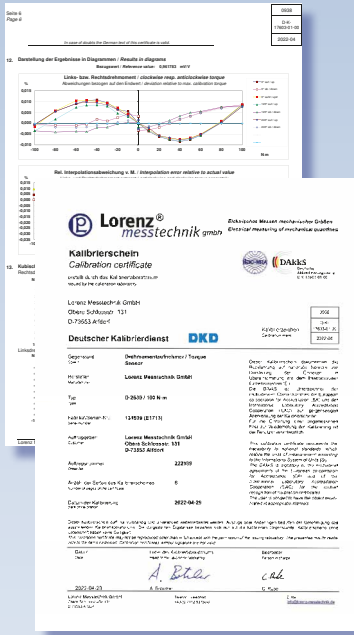

- ▶ Kalibrierergebnis
- ▶ Messunsicherheit
- ▶ Klasseneinteilung
- ▶ Interpolationsgleichungen
- ▶ Messwerte
- ▶ Grafische Darstellung der Messergebnisse

Die Kalibrierhierarchie



QM-System

Unser bestehendes QM-System nach DIN EN ISO 9001 wurde um die für Laboratorien gültige Norm DIN EN ISO/IEC 17025 erweitert.



Der Kalibrierschein ist nur unterschrieben gültig.

DAkKS-Kalibriermarke

Auf den kalibrierten Drehmomentensensoren wird zum Abschluss eine Kalibriermarke angebracht. Die Kalibriermarke und der Kalibrierschein haben die gleiche Nummer.



DAkKS-Kalibrierscheine werden international anerkannt.

Die Rückführbarkeit unserer Kalibrierungen von Drehmomentensensoren ist durch die Akkreditierung unseres Kalibrierlabor gewährleistet.

